

Deutsch  
English

Español  
Français

Italiano

# Quickstart Guide Vet Cuff Conversion Kit

# SunTech Medical®



Vet BP



SunTech Medical, Inc.  
507 Airport Boulevard, Suite 117  
Morrisville, NC 27560-8200 USA  
Tel: + 1.919.654.2300  
1.800.421.8626  
Fax: + 1.919.654.2301  
SunTechMed.com




SunTech Medical, Ltd.  
Oakfield Industrial Estate  
Stanton Harcourt Road  
Eynsham, Oxfordshire OX29 4TS  
England  
Tel: + 44 (0) 1865.884.234  
Fax: + 44 (0) 1865.884.235  
SunTechMed.com

SunTech Medical, Ltd.  
105 HuanGuan South Road, Suite 15 2~3/F  
DaHe Community Guanlan,  
LongHua District, Shenzhen  
GuangDong PRC 518110  
Tel: + 86-755-2958 8810  
+ 86-755-29588986 (Sales)  
+ 86-755-29588665 (Service)  
Fax: + 86-755-2958 8829  
SunTechMed.com.CN


  
**SunTech Medical®**  
The Difference in Clinical Grade™

82-0534-00-RevA

# 1



# 2

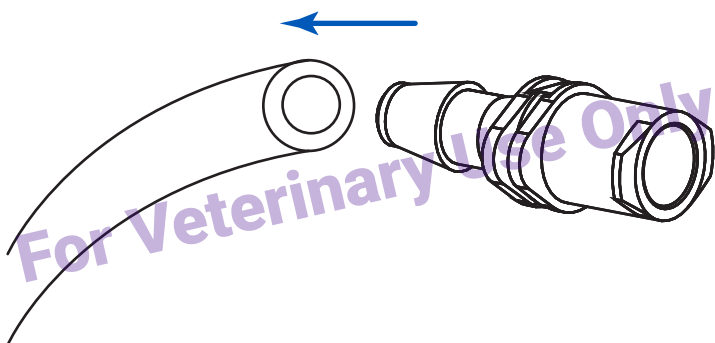

Download operating instructions for this product by visiting [suntechmed.com/library](http://suntechmed.com/library). View the instructions for this product using Adobe Acrobat Reader, or any compatible PDF reader, on any computer or mobile device with an internet connection.

**!** WARNING: DO NOT connect patient hose or monitor to any other devices or connections, especially intravenous (IV) tubes as there is potential for air to be pumped into a blood vessel which could cause serious injury.

Pour télécharger les instructions d'utilisation de ce produit, rendez vous à l'adresse [suntechmed.com/library](http://suntechmed.com/library). Pour lire les instructions d'utilisation de ce produit, utilisez Adobe Acrobat Reader ou un lecteur PDF compatible, sur tout ordinateur ou appareil mobile connecté à Internet.

**!** AVERTISSEMENT : NE PAS raccorder le tube patient ou le moniteur à d'autres appareils ou raccords, en particulier des tubes intraveineux (IV) car il y a un risque que de l'air soit pompé dans un vaisseau sanguin, ce qui peut causer des blessures graves.

Die Gebrauchsanweisung für das Produkt können Sie hier herunterladen: [suntechmed.com/library](http://suntechmed.com/library). Sie können die Gebrauchsanweisung an jedem PC oder mobilen Endgerät mit Internet-Anschluss mit dem Adobe Acrobat Reader oder einem kompatiblen Reader öffnen und lesen.

**!** WARNUNG: Verbinden Sie den Patientenschlauch oder den Monitor NICHT mit anderen Geräte oder Anschlüssen, insbesondere Infusionsschläuche, da dies die Gefahr birgt, dass Luft in ein Blutgefäß gepumpt wird, was zu schwersten Verletzungen führen kann.

Per scaricare le istruzioni operative per questo prodotto, visitare la pagina [suntechmed.com/library](http://suntechmed.com/library). Visualizzare le istruzioni per questo prodotto utilizzando Adobe Acrobat Reader o un altro programma per la lettura di PDF compatibile, su qualsiasi computer o dispositivo mobile con connessione a Internet.

**!** AVVERTENZA: NON collegare il tubicino del paziente o il monitor ad altri dispositivi o connettori, in particolare a tubicini per infusioni endovenose, in quanto sussiste il rischio di pompare aria in un vaso ematico con conseguenti gravi lesioni.

En [suntechmed.com/library](http://suntechmed.com/library) usted podrá descargar las instrucciones para el uso de este producto. Para ver las instrucciones de este producto, utilice Adobe Acrobat Reader u otro lector de PDF compatible en cualquier ordenador o dispositivo móvil con conexión a Internet.

**!** ADVERTENCIA: NO conecte el tubo del paciente ni el monitor a ningún otro equipo o conexión, especialmente tubos intravenosos (IV), ya que el aire podría ser bombeado a un vaso sanguíneo y provocar graves lesiones.